

黄嘌呤氧化酶活性检测试剂盒(WST-8法)

产品编号	产品名称	包装
S0110S	黄嘌呤氧化酶活性检测试剂盒(WST-8法)	100次

产品简介:

- 碧云天研发的黄嘌呤氧化酶活性检测试剂盒(WST-8法), 即Xanthine Oxidase Activity Assay Kit with WST-8, 也称XO Activity Assay Kit with WST-8或XOD Activity Assay Kit with WST-8, 是一种基于WST-8的显色反应, 利用吸光度检测, 简单、快速、灵敏地用于血清、血浆、尿液等生物体液、组织、细胞以及细胞培养上清等样品中黄嘌呤氧化酶活性检测的试剂盒。通常0.2-1μl血清或血浆样品就足够用于本试剂盒的检测。
- 黄嘌呤氧化酶(Xanthine oxidase, XO or XOD)是体内核酸代谢中的一种重要酶, 可以催化次黄嘌呤氧化为黄嘌呤, 并能进一步催化黄嘌呤氧化为尿酸, 同时产生过氧化氢以及超氧化物阴离子的一系列氧化反应, 在包括人类在内的一些物种中的嘌呤分解代谢中起着重要作用[1]。在人类及其它灵长类动物中, XO通常存在于血清、肺、肝脏和肠黏膜中。在啮齿类动物中, XO在大部分组织中均有表达。血液中XO的活性通常都很低。当感染甲型流感时, 血清及肺部的XO活性会增加[2]。当肝功能受损时, XO会大量释放到血液中, 因此检测血液中XO水平被作为一个评估严重肝损伤(例如黄疸)的灵敏指标[3]。
- 本试剂盒的检测原理请参考图1。底物(Substrate)在XO催化作用下产生的超氧化物阴离子(O₂⁻), 随后与WST类指示剂(Indicator)反应产生水溶性的甲臞染料(Formazan dye)。甲臞染料在450nm左右有最大吸收峰, 甲臞染料的生成量与黄嘌呤氧化酶的活性成正比, 通过测定450nm处的吸光度就可以非常灵敏地检测样品中黄嘌呤氧化酶活性。



图1. 碧云天黄嘌呤氧化酶活性检测试剂盒(WST-8法) (S0110)的原理图。

- 本试剂盒检测灵敏度高, 线性范围宽, 样品用量少。本试剂盒在样品体积为20μl时, 可以检测活性低至4μU的黄嘌呤氧化酶, 在0.2-30mU/ml (4-600μU)活性范围内有良好的线性关系。本试剂盒提供了配制黄嘌呤氧化酶标准溶液的XO (2U/ml), 可以通过绘制标准曲线(图2), 从而计算出样品中的黄嘌呤氧化酶的活性。如果样品量较少或者样品中黄嘌呤氧化酶的活性较低, 可以使用检测灵敏度更高的Amplex Red黄嘌呤氧化酶活性检测试剂盒(S0112)。

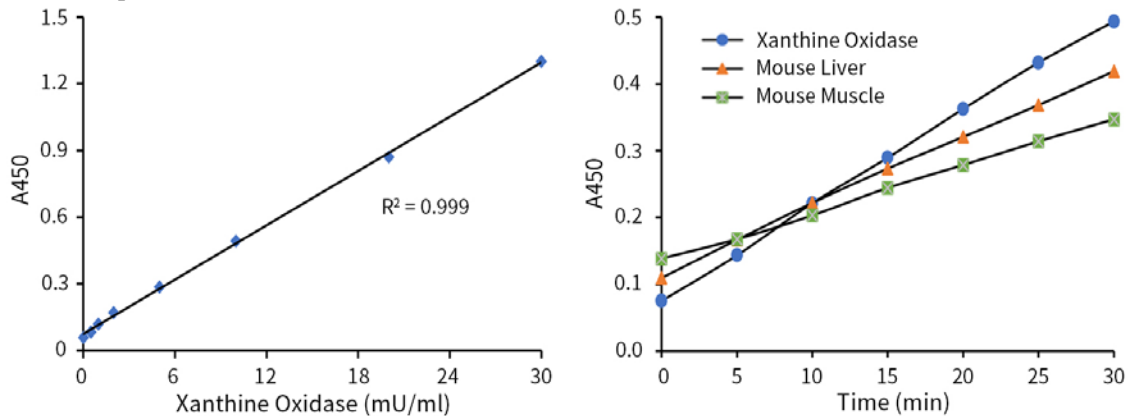


图2. 碧云天黄嘌呤氧化酶活性检测试剂盒(WST-8法) (S0110)对黄嘌呤氧化酶标准品及小鼠不同组织样品的检测效果图。左图为黄嘌呤氧化酶的标准曲线图, 各浓度的黄嘌呤氧化酶标准品和Chromogen Working Solution混匀后, 37°C反应30分钟, 测定A450, 在0.2-30mU/ml活性范围内有良好的线性关系。右图为10mU/ml黄嘌呤氧化酶、320μg蛋白量的小鼠肝脏(Mouse liver)裂解样品、125μg蛋白量的小鼠肌肉(Mouse muscle)裂解样品加入Chromogen Working Solution并匀混后, 在37°C反应30分钟内的吸光度信号变化图。实测数据会因实验条件、检测仪器等的不同而存在差异, 图中数据仅供参考。

- 本试剂盒提供的检测裂解液有一定的通用性。使用本试剂盒中的BeyoLysis™ Buffer A for Metabolic Assay裂解获得的细胞或组织样品, 也可以用于碧云天生产的其它代谢类试剂盒中同样使用BeyoLysis™ Buffer A for Metabolic Assay进行裂解的样品检测, 通用性强; 而且还可用于检测蛋白浓度、进行SDS-PAGE或一些较易溶解蛋白的Western检测。
- 本试剂盒使用灵活, 检测速度快, 适用范围广。本试剂盒可用于小鼠、大鼠、人等的血清、血浆、尿液等生物体液, 细胞培养上清、组织或细胞样品等的检测, 全程约0.5-1小时即可完成。本试剂盒不仅适合少量样品的检测, 也非常适合高通量筛选(High-throughput screening)的自动化操作系统。
- 按照使用说明操作, 用于96孔板检测时, 本试剂盒的小包装可以进行100次检测。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
S0110S-1	BeyoLysis™ Buffer A for Metabolic Assay	30ml
S0110S-2	XO Assay Buffer	30ml
S0110S-3	XO (2U/ml)	25µl
S0110S-4	XO Indicator (100X)	100µl
S0110S-5	XO Substrate	150µl
—	说明书	1份

保存条件:

-20°C保存, 一年有效。XO Indicator须避光保存。

注意事项:

- BeyoLysis™ Buffer A for Metabolic Assay、XO Assay Buffer、XO Indicator需要完全解冻并平衡至室温后再使用, 否则会影响检测结果。XO使用时应在冰上进行, 使用完毕后各试剂应立即按照试剂盒保存的条件进行保存。
- 血清等样品如在4°C保存, 保存时间不得超过2周, 否则会影响检测结果的准确性。通常血清样品宜-20°C保存, -80°C保存更佳。
- 为减少稀释液产生的背景带来的误差, 样品和标准品的稀释液应该根据样品的种类来定。当样品为BeyoLysis™ Buffer A for Metabolic Assay制备的细胞或组织的裂解样品时, 应使用BeyoLysis™ Buffer A for Metabolic Assay稀释; 当样品为血液等其它样品时, 应使用XO Assay Buffer稀释。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:

1. 样品的准备:

- 血液样品的准备: 对于血清样品, 将全血在常温如25°C下放置30分钟至2小时, 不要剧烈摇晃以免溶血, 待全血自然凝固并析出血清后, 4°C约1000-2000×g离心10分钟, 取黄色上清即得血清, 注意不要吸取白色或淡黄色沉淀; 对于血浆样品, 将全血用肝素或者EDTA进行抗凝, 4°C约1000-2000×g离心10分钟, 取黄色或淡黄色上清即得血浆, 注意不要吸取白色沉淀。血清和血浆都需置于冰上, 如果不能立即检测, 也可以分装并短期保存于-20°C或-80°C。对于冻存的样品, 在检测前解冻后冰浴存放备用, 使用前必须混匀。
- 细胞或组织样品的准备: 对于培养的贴壁细胞, PBS (C0221A)洗涤一次并吸净残留液体。对于培养的悬浮细胞, 先适当离心(如100-500×g, 5分钟)收集细胞到离心管内, 弃上清并吸净残留液体。按照每100万细胞加入100-200µl BeyoLysis™ Buffer A for Metabolic Assay的比例加入裂解液, 适当吹打, 冰浴5-10分钟以充分裂解细胞。4°C约12,000×g离心3-5分钟, 取上清用于后续检测。对于组织样品, 按照每10mg组织加入100µl BeyoLysis™ Buffer A for Metabolic Assay的比例, 使用TissueMaster™高通量组织研磨仪(1.5/2ml×48) (E6618)、TissueMaster™手持式组织研磨仪(E6600)或玻璃匀浆器在约4°C或冰浴等低温条件下进行匀浆。4°C约12,000×g离心3-5分钟, 取上清用于后续检测。以上所有操作均需在4°C或冰上操作。制备好的细胞或组织样品如果不能立即检测, 可以-20°C或-80°C冻存。
- 细胞培养上清样品的准备: 对于贴壁细胞, 直接取培养液; 对于悬浮细胞, 离心取培养液。

2. 试剂盒的准备:

- 融解除XO以外的其它所有试剂并平衡至室温。XO置于冰浴备用, 使用完毕后宜立即按照试剂盒要求的条件保存。
- Chromogen Working Solution的配制: 按照每个样品需要80µl Chromogen Working Solution的量配制适量的Chromogen Working Solution。均匀混合77.5µl XO Assay Buffer、1µl XO Indicator (100X)、1.5µl XO Substrate, 即可配制成80µl Chromogen Working Solution。具体配制方法参考下表。配制好的Chromogen Working Solution如果置于4°C或冰浴避光保存, 可以在当天使用, 但建议尽量现配现用。

Samples	1	10	20	50
XO Assay Buffer (µl)	77.5	775	1550	3875
XO Indicator (100X) (µl)	1	10	20	50
XO Substrate (µl)	1.5	15	30	75
Chromogen Working Solution (µl)	80	800	1600	4000

3. 样品测定:

- 黄嘌呤氧化酶标准曲线的设置: 取3µl XO (2U/ml), 加入197µl XO BeyoLysis™ Buffer A for Metabolic Assay或XO Assay Buffer (如果检测BeyoLysis™ Buffer A for Metabolic Assay制备的细胞或组织裂解样品, 使用BeyoLysis™ Buffer A for Metabolic Assay; 如果检测血液、上清等无需处理的样品, 使用XO Assay Buffer), 混匀, 即得浓度为30mU/ml的XO。分别取30mU/ml的XO 1、2、4、8、12、16、20µl加入96孔板的标准品孔中, 并用对应的BeyoLysis™ Buffer A for Metabolic Assay或XO Assay Buffer补足至20µl, 此时标准曲线的浓度为0、1.5、3、6、12、18、24、30mU/ml。
- 取1-20µl稀释后的样品至96孔板样品孔中, 并相应地再加入BeyoLysis™ Buffer A for Metabolic Assay或XO Assay Buffer至样品孔中, 补足到20µl。同时设置仅含BeyoLysis™ Buffer A for Metabolic Assay或XO Assay Buffer的孔为空白对照

孔。

注：为确保数值在标准曲线范围内，建议将样品同时设定多个稀释倍数。可以进行预实验确定样品的大致浓度，如果数值不在标准曲线范围内，可调整样品的稀释倍数或者增加样品的用量。如果是BeyoLysis™ Buffer A for Metabolic Assay制备的细胞或组织裂解样品，使用BeyoLysis™ Buffer A for Metabolic Assay稀释；如果是血液、上清等无需处理的样品，使用XO Assay Buffer稀释。此处的样品总稀释倍数记为n（例如本步骤中对样品进行了10倍稀释，加入的‘稀释后的样品’为10μl，则n=10×20/10=20）。

- c. 各孔加入Chromogen Working Solution 80μl，混匀，37°C反应30分钟。注：如果吸光度偏低，可适当延长反应时间。
- d. 在450nm测定吸光度。
- e. 建立标准曲线，并计算样品中黄嘌呤氧化酶的活性A。黄嘌呤氧化酶标准曲线可以参考图2，在0.2-30mU/ml活性范围内有良好的线性关系。黄嘌呤氧化酶活性计算公式如下：

$$C (\text{mU/ml}) = A \times n$$

注：A为步骤3e根据标准曲线确定的黄嘌呤氧化酶活性；

n为步骤3b样品总稀释倍数。

黄嘌呤氧化酶活性单位的定义为：在室温条件下，每分钟催化黄嘌呤产生1.0μmol尿酸和过氧化氢所需的酶量。

参考文献：

1. Hille R, Hall J, Basu P. Chem Rev. 2014. 114(7):3963-4038.
2. Hemilä H. Br J Nutr. 1992. 67(1):3-16.
3. Battelli MG, Musiani S, Valgimigli M, Gramantieri L, Tomassoni F, et al. Am J Gastroenterol. 2001. 96(4):1194-1199.

相关产品：

产品编号	产品名称	包装
C0016/C0017	乳酸脱氢酶细胞毒性检测试剂盒	100次/500次
C0018S/M	乳酸脱氢酶细胞毒性检测试剂盒(WST-8法)	100次/500次
S0110S	黄嘌呤氧化酶活性检测试剂盒(WST-8法)	100次
S0111S	黄嘌呤氧化酶抑制剂筛选试剂盒(WST-8法)	100次
S0112S/M	Amplex Red黄嘌呤氧化酶活性检测试剂盒	100次/500次
S0113S	Amplex Red黄嘌呤氧化酶抑制剂筛选试剂盒	100次
S0114S	黄嘌呤/次黄嘌呤检测试剂盒(WST-8法)	100次
S0204S	D-乳酸检测试剂盒(WST-8法)	100次
S0208S	L-乳酸检测试剂盒(WST-8法)	100次
S0211S/M	Amplex Red胆固醇与胆固醇酯检测试剂盒	100次/500次
S0215S/M	Amplex Red游离脂肪酸检测试剂盒	100次/500次
S0219S/M	Amplex Red甘油三酯检测试剂盒	100次/500次
S0223S/M	Amplex Red甘油检测试剂盒	100次/500次
S0227S	Amplex Red L-乳酸检测试剂盒	100次
S0231S	Amplex Red尿酸与尿酸酶检测试剂盒	100次
S0235S	Amplex Red磷酸盐检测试剂盒	100次
S0239S	Amplex Red乙醇检测试剂盒	100次
S0243S/M	Amplex Red黄嘌呤/次黄嘌呤检测试剂盒	100次/500次
S0247S	Amplex Red谷氨酸与谷氨酸氧化酶检测试剂盒	100次
S0251S	Amplex Red过氧化氢与过氧化物酶检测试剂盒	100次
S0255S	Amplex Red过氧化氢酶检测试剂盒	100次
S0259S	Amplex Red单胺氧化酶检测试剂盒	100次
S0263S	Amplex Red鞘磷脂酶检测试剂盒	100次
S0267S	Amplex Red胆碱与乙酰胆碱检测试剂盒	100次
S0271S	Amplex Red乙酰胆碱酯酶检测试剂盒	100次
S0275S	Amplex Red磷脂酰胆碱检测试剂盒	100次
S0279S	Amplex Red磷脂酶D检测试剂盒	100次
S0283S	Amplex Red肌酸检测试剂盒	100次
S0287S	Amplex Red肌酸激酶检测试剂盒	100次
S0291S	Amplex Red肌酐检测试剂盒	100次
S0295S	Amplex Red肌氨酸检测试剂盒	100次
S0299S	Amplex Red丙酮酸检测试剂盒	100次

S0303S	Amplex Red丙酮酸激酶检测试剂盒	100次
S0307S	Amplex Red ADP检测试剂盒	100次
S0311S	Amplex Red磷酸烯醇式丙酮酸检测试剂盒	100次
S0315S	Amplex Red丙氨酸检测试剂盒	100次
S0319S	Amplex Red丙氨酸转氨酶检测试剂盒	100次
S0323S	Amplex Red α -酮戊二酸检测试剂盒	100次
S0327S	Amplex Red天冬氨酸检测试剂盒	100次
S0331S	Amplex Red天冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒	100次
S0335S	Amplex Red柠檬酸检测试剂盒	100次
S0339S	Amplex Red草酰乙酸检测试剂盒	100次
S0343S	Amplex Red葡萄糖检测试剂盒	100次
S0347S	Amplex Red葡萄糖氧化酶检测试剂盒	100次
S0351S	Amplex Red果糖检测试剂盒	100次
S0355S	Amplex Red乳糖检测试剂盒	100次
S0359S	Amplex Red半乳糖与乳糖检测试剂盒	100次
S0363S	Amplex Red半乳糖与半乳糖氧化酶检测试剂盒	100次
S0367S	Amplex Red麦芽糖检测试剂盒	100次
S0371S	Amplex Red麦芽糖与葡萄糖检测试剂盒	100次
S0375S	Amplex Red糖原检测试剂盒	100次
S0379S	Amplex Red磷酸果糖激酶检测试剂盒	100次
S0383S	Amplex Red乙酰辅酶A检测试剂盒	100次
S0387S	Amplex Red辅酶A检测试剂盒	100次
S0391S	Amplex Red乙酰辅酶A合成酶检测试剂盒	100次
S0511S	L-苹果酸检测试剂盒(WST-8法)	100次
S0514S	苹果酸脱氢酶活性检测试剂盒(WST-8法)	100次
S0517S	延胡索酸检测试剂盒(WST-8法)	100次
S0520S	延胡索酸酶活性检测试剂盒(WST-8法)	100次
S0523S	异柠檬酸检测试剂盒(WST-8法)	100次
S0526S	异柠檬酸脱氢酶活性检测试剂盒(WST-8法)	100次
S0529S	Amplex Red琥珀酸检测试剂盒	100次
S0530S	琥珀酸脱氢酶活性检测试剂盒(显色法)	100次
S0532S	Amplex Red琥珀酰辅酶A合成酶检测试剂盒	100次
S0535S	支链氨基酸检测试剂盒(WST-8法)	100次
S0538S	N-乙酰氨基葡萄糖苷酶活性检测试剂盒(显色法)	100次
S0540S	酪氨酸检测试剂盒(显色法)	100次
S0542S	酪氨酸酶活性检测试剂盒(显色法)	100次
S0545S	酪氨酸酶抑制剂筛选试剂盒(显色法)	100次
S0547S	髓过氧化物酶活性检测试剂盒(显色法)	100次
S0548S	Amplex Red髓过氧化物酶活性检测试剂盒	100次
S0550S	Amplex Red髓过氧化物酶抑制剂筛选试剂盒	100次

Version 2024.08.06